

SURGIFLO™ Kit Matrice Emostatica

SURGIFLO™ e via




**Il sanguinamento non aspetta.
Neanche tu dovresti.**

SURGIFLO™ Matrice Emostatica fornisce consistenza e viscosità uniformi dall'inizio alla fine.^{1*}

In test condotti in cieco, i chirurghi preferiscono la consistenza di SURGIFLO™ Matrice Emostatica rispetto a Floseal.^{2**}

Surgiflo mostra una minore variazione di consistenza rispetto a Floseal (6.3% vs 62%)^{3#}

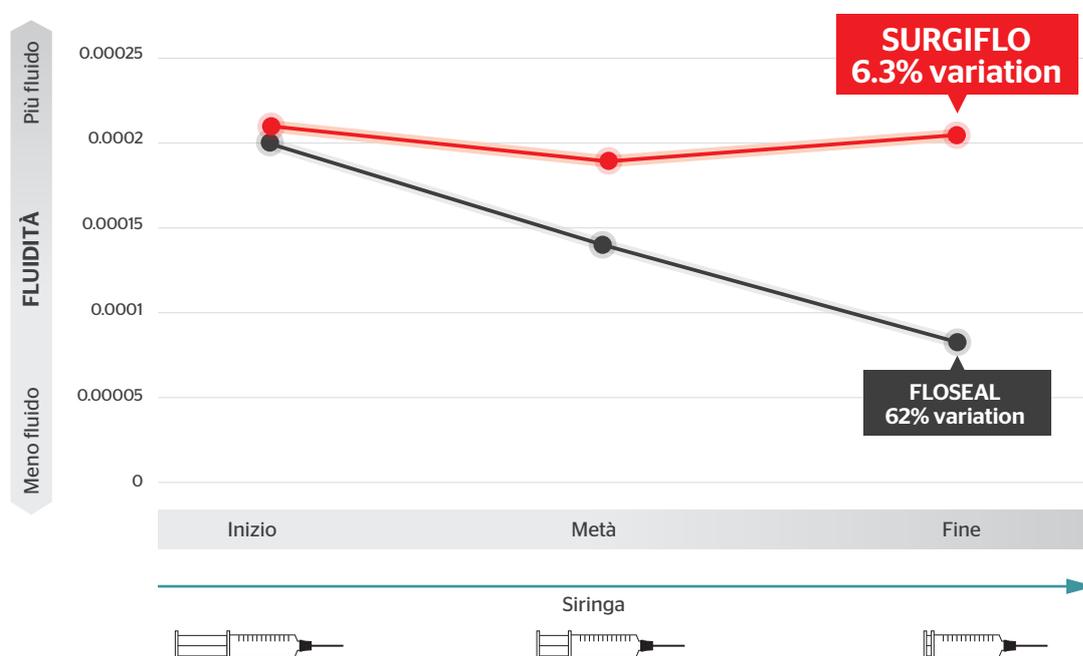

Surgiflo™ Matrice Emostatica con trombina si comporta in modo simile a Floseal, raggiungendo l'emostasi entro circa 60 secondi dall'applicazione.^{4†}

*Basato su test di viscosità in vitro di SURGIFLO™ 8 mL e FLOSEAL™ Matrice Emostatica 5 mL. Ogni prodotto è stato preparato seguendo le istruzioni per l'uso e misurato immediatamente dopo la preparazione ** Test condotti con 101 chirurghi statunitensi # Basato su test di viscosità in vitro di SURGIFLO™ 8 mL e FLOSEAL™ Matrice Emostatica 5 mL. Ogni prodotto è stato preparato seguendo le istruzioni per l'uso e misurato immediatamente dopo la preparazione † In modelli animali.

1. Ethicon, 07042013, Measurements of Viscosity and Thrombin Activity of SURGIFLO 2993 as Compared to FLOSEAL Over Time, April 2013, Data on File (075957-170711) 2. Ethicon, 01082014, Surgiflo™ Claims Research, Aug 2014, Data on File (075957-170711) 3. Ethicon, 07042013, A Measurements of viscosity and thrombin activity of SURGIFLO™ 2993 as compared to FLOSEAL™ over time, April 2013, Data on File (150986-200825) 4. Ethicon, 07102013, Evaluation of the dose response curve for Hemostatic Efficacy of Surgiflo Next Generation mixed with Thrombin, Oct 2013, Data on File. Pilot Evaluation comparing time to hemostasis (075957-170711)

SURGIFLO™ Matrice Emostatica ha un profilo di sicurezza dimostrato.⁵

SURGIFLO™ è supportato da numerosi studi clinici. Una revisione sistematica ed una metanalisi di 6 studi clinici su 39,660 pazienti, non hanno dimostrato differenze statisticamente significative rispetto alla Matrice Emostatica Floseal in termini di efficacia e sicurezza rispetto ai seguenti endpoints^{6*#¥}.


Trasfusioni di sangue



Complicazioni minori/maggiori



Tempo chirurgico/ operatorio

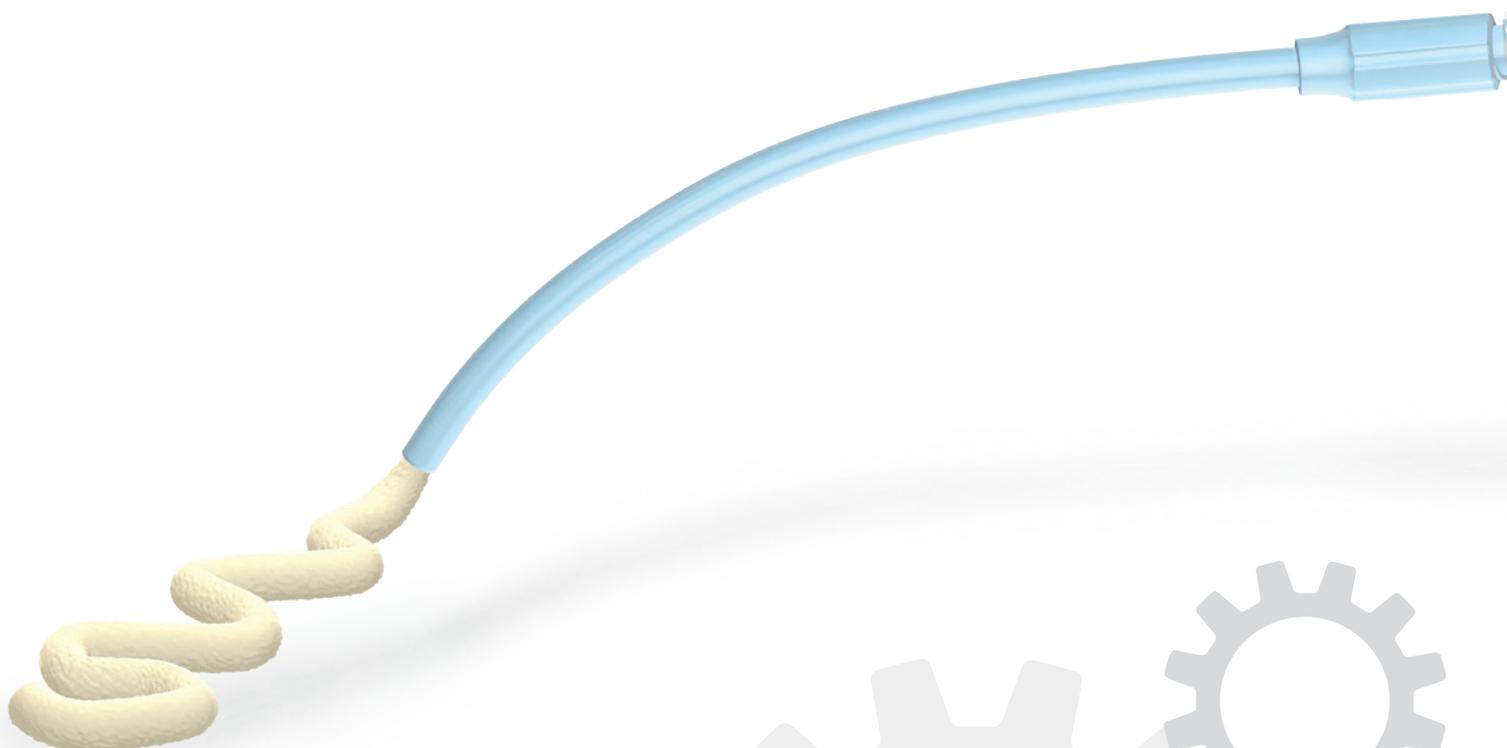

*Rispetto a Floseal™, entrambi i prodotti hanno dimostrato un profilo di sicurezza ed efficacia simile ≠ Per indicazioni complete, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e reazioni avverse, fare riferimento al foglietto illustrativo completo. ¥ Attraverso i seguenti endpoint: trasfusioni di sangue, complicazioni minori / maggiori, tempo chirurgico / operatorio.

5. Gazzeri, The Safety and Biocompatibility of Gelatin Hemostatic Matrix (Floseal and Surgiflo™) in Neurosurgical Procedures, Surg Technol Int;2012;22:49 (075957-170711)

6. Palleja, Systematic Revision and MetaAnalysis of Geletin Thrombin Hemostatic Matrices for Bleeding Control, Value in Health. 06;9:3:A3 (506-0087)

SURGIFLO™ Matrice Emostatica è due volte più veloce da preparare rispetto a Floseal (81 vs. 163 secondi) e non richiede misurazioni.^{7*}

Pronto all'uso in

30 secondi

una volta avvenuto il passaggio in campo sterile della trombina liquida o della soluzione sterile^{8,9}

Il tempo di ricostituzione della trombina è significativamente più breve rispetto a Floseal

(57 secondi vs. 90 secondi)¹⁰



Arresta il sanguinamento prima che Floseal™ sia pronto all'uso^{11,12*}

*Tenendo in considerazione che: la matrice emostatica SURGIFLO™ è due volte più veloce da preparare rispetto a Floseal (8 contro 63 secondi) e non richiede misurazioni. Il tempo specifico è di 81 secondi vs. 163 secondi e la matrice emostatica SURGIFLO™ con trombina si comporta in modo simile a Floseal, raggiungendo l'emostasi entro circa 60 secondi dall'applicazione, nei modelli animali.

7. Ethicon, SURGIFLO™ Hemostatic Matrix Kit with Thrombin, Dec 2013, Data on File (075957-170711) **8.** Ready to use in 30 seconds or less once liquid thrombin or saline is delivered to sterile field (075957-170711) **9.** Ethicon, 11052017, Comparison of Thrombin Reconstitution Time, May 2017, Data on File (075957-170711)

10. Ethicon, MD-TMSR-512-204.01 SURGIFLO™ Hemostatic Matrix Kit with Thrombin, Dec 2013, Data on File (075957-170711) **11.** Ethicon, MD-TMSR-512-204.01 SURGIFLO™ Hemostatic Matrix Kit with Thrombin, Dec 2013, Data on File (150139-200817) **12.** Ethicon, 07102013, Evaluation of the dose response curve for Hemostatic Efficacy of Surgiflo Next Generation mixed with Thrombin, Oct 2013, Data on File. (150139-200817)

Costo-Efficacia

Analisi retrospettiva di procedure di fusione spinale e rifusione



I costi della procedura sono stati confrontati per le procedure in cui è stato utilizzato **SURGIFLO™ Kit Matrice Emostatica** rispetto alle procedure in cui è stato utilizzato **FLOSEAL¹³**

Nello studio, sono state considerate tutte le procedure da una fusione di primo livello fino a casi più complicati di deformazioni o scoliosi dell'adulto che coinvolgono più livelli¹³

Sono stati identificati 9.794 pazienti sottoposti a chirurgia della colonna che hanno ricevuto SURGIFLO™ e 15.088 pazienti che hanno ricevuto Floseal¹³

Lo studio ha rilevato che si risparmia in media \$65* sui costi della matrice Fluida passando da Floseal a SURGIFLO™ con trombina¹³**

Con l'aumentare della durata dell'intervento, aumenta il risparmio sui costi associato all'uso di SURGIFLO™ con trombina; per ogni ora chirurgica trascorsa in più vengono risparmiati \$21^{13#}

Non c'era nessuna differenza statisticamente significativa negli esiti clinici osservati tra i pazienti trattati con SURGIFLO™ rispetto a Floseal¹³

* Età, sesso, tipo di intervento chirurgico, dimensioni dell'ospedale sono solo alcuni dei fattori statisticamente monitorati nel confronto tra SURGIFLO™ e Floseal

** \$300 = €259,94, \$200 = €173,29, \$100 = €86,65. Tasso di conversione 1 dollaro pari a 0,86555 euro

*** \$65 = € 56,32. Tasso di conversione 1 dollaro pari a 0,86555 euro

\$21 = €18,20. Tasso di conversione 1 dollaro pari a 0,86555 euro

13. David, Similar patient outcomes yet different hospital costs between flowable hemostatic agents, Journal of Medical Economics;2015;9;19;735-745



SURGIFLO™ Kit Matrice Emostatica— consente un flusso più veloce degli interventi chirurgici



Codice	Descrizione	Pezzi per conf.
MS0012M	8 mL SURGIFLO™ Matrice Emostatica con trombina	6
MS0010M	8 mL SURGIFLO™ Matrice Emostatica	6
MS1995	34 cm Applicatore Endoscopico	6

Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante Ethicon di zona.

Si prega di fare sempre riferimento alle istruzioni per l'uso/foglietto illustrativo che viene fornito con il dispositivo per avere le istruzioni più aggiornate e complete.

Ethicon Biosurgery
Johnson & Johnson Medical S.p.A.

Per ordini e consegne
SERVIZIO CLIENTI:
Tel. 06 91194500 - Fax 06 91194505
E-mail: ordini@its.jnj.com - E-mail: cservice@its.jnj.com

Per richieste di offerte commerciali
UFFICIO CENTRALIZZATO GARE:
Tel. 06 91194400 - Fax 06 91194270
E-mail: ufficiogare@its.jnj.com

Responsabile Servizio Scientifico Ethicon Biosurgery:
Tel. 06 911941 - Cell. 348 9357214

ETHICON
PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

Shaping
the future
of surgery